

Số: 23 /YCBG-TTYT  
V/v Mời báo giá vật tư y tế - hóa chất

Tân Sơn, ngày 06 tháng 1 năm 2025

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm y tế huyện Tân Sơn với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn

- Địa chỉ: Khu 5B – Thị trấn Tân Phú – huyện Tân Sơn – tỉnh Phú Thọ

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bùi Thị Vân Anh – Thủ kho vật tư y tế

Điện thoại: 0976.301.425

Email: [khoaduocbvtanson@gmail.com](mailto:khoaduocbvtanson@gmail.com)

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: một trong các cách thức sau:

- Gửi về địa chỉ: Khoa Dược - VTYT, Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn; Khu 5B, Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- Hoặc Email: [khoaduocbvtanson@gmail.com](mailto:khoaduocbvtanson@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h30 ngày 06 tháng 01 năm 2025 đến trước 17h ngày 06 tháng 01 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2025.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế - hóa chất

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	ĐVT
1	Sonde folay 2 nhánh số 16	Foley 2 nhánh phủ silicon cao cấp, mã hóa màu kích cỡ, các số 6-30F	200	Cái

2	Gạc hút y tế	<p>Chất liệu 100% sợi cotton, gạc được dệt thành khổ lớn (khổ 0.8 m).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấu trúc 100 sợi cotton mềm mại, không gây kích ứng da.</li> <li>- Nguyên liệu nguồn gốc rõ ràng, thân thiện với môi trường.</li> <li>- Đóng thành từng tập, mỗi tập 20m</li> </ul>	4.000	Mét
3	Chi Dafilon số 3	Chi không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, số 3/0, dài 75cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn DS 24mm, công nghệ kim Easyslide, làm bằng thép không gỉ AISI 300 series (304) phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 15.05N. Đóng gói trực tiếp 2 lớp: lá nhôm bên trong, vỏ nhựa bên ngoài.	72	Sợi
4	Huyết thanh mẫu Anti AB	Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-Ab kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A-5E10;B-2D7 1,0ml. ISO-13485	10	Lọ
5	Dây nối bơm tiêm điện	Có dây dẫn dài 1400mm, đường kính ngoài của dây 1.1 mm, dây dẫn làm bằng chất liệu nhựa cứng lực có độ đàn hồi tốt, có khoá an toàn, không gây độc hại kích ứng, bao bì sản phẩm có băng giấy thoát khí EO	1.000	Cái
6	Que thử ma túy tổng hợp 5 chân MET-THC-MDMA-MOP-KET/COC	Que thử ma túy tổng hợp 5 chân – Multi Drug 5– Multi Drug 5 Panel Test là bộ test nhanh tích hợp nhiều que thử để định tính phát hiện các chất gây nghiện MET-THC-MDMA-MOP-KET/COC trên một bảng nhựa duy nhất. Các đầu thấm hút mẫu được gắn cùng chiều để có thể nhúng đồng thời vào mẫu nước tiểu. Kết quả xét nghiệm với mỗi chất gây nghiện sẽ được hiển thị trong một kết quả riêng biệt. Nhờ đó chỉ cần làm xét nghiệm một lần với một mẫu nước tiểu là có thể đồng thời kiểm tra, sàng lọc được nhiều chất gây nghiện, đồng thời cho kết quả những chất gây nghiện mà đối tượng đã sử dụng.	100	Test
7	Que tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm cán gỗ	Ống nhựa PP, nắp nhựa HDPE, đầu bông, que gỗ. Được sử dụng trong y tế để lấy mẫu, lưu trữ, truyền tải. Được sử dụng rộng rãi trong nha khoa, da liễu, phụ khoa, tiết niệu và các mẫu lấy mẫu khác	500	Cái
8	Microshiel2%	Dung dịch rửa tay thủ thuật, thường quy CHLORHEXIDINE GLUCONATE 2%	10	Chai
9	Aso Latex	<p>ASO-latex là xét nghiệm ngưng kết trên lam kính để phát hiện định tính và bán định lượng kháng thể kháng streptolysin O.</p> <p>Các hạt latex phủ streptolysin O sẽ ngưng kết khi trộn với mẫu chứa ASO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành phần:</li> <li>+ Latex: Các hạt latex phủ streptolysin O, pH, 8.2.</li> <li>+ Control (+): Huyết thanh người chứa ASO nồng độ &gt;200 IU/mL</li> </ul>	5	Hộp

		+ Control (-): Huyết thanh động vật - Độ nhạy : 98% - Độ đặc hiệu : 97% - Bảo quản: 2-8 °C - TCCL: ISO 13485, C		
10	Troca 5	Thiết kế kín khí độ dao chống rò rỉ khí gas. Thiết kế hạt chống trơn trượt, tăng độ ma sát giữa thành bụng và thành bụng, tránh hạt bị rơi ra. Định vị phổ quát của hình nón thủng mà không cần chèn hướng	20	Cái
11	Miếng dán điện cực tim	Dung dịch được sử dụng để khử khuẩn mức độ cao cho các dụng cụ y tế bán thiết yếu sử dụng nhiều lần, nhạy cảm với nhiệt. Nó cũng có thể được dùng để khử khuẩn các dụng cụ nội soi bằng máy rửa, khử khuẩn ống nội soi. Thời gian ngâm: Khử khuẩn mức độ cao là 5 phút, 20 độ C. Thời gian sử dụng dung dịch đã ngâm: 14 ngày. Thời gian sử dụng dung dịch trong can đã mở nắp: 75 ngày. Bảo quản: 15 - 30 độ C	100	Cái
12	Cidex OPA	Dung dịch được sử dụng để khử khuẩn mức độ cao cho các dụng cụ y tế bán thiết yếu sử dụng nhiều lần, nhạy cảm với nhiệt. Nó cũng có thể được dùng để khử khuẩn các dụng cụ nội soi bằng máy rửa, khử khuẩn ống nội soi. Thời gian ngâm: Khử khuẩn mức độ cao là 5 phút, 20 độ C. Thời gian sử dụng dung dịch đã ngâm: 14 ngày. Thời gian sử dụng dung dịch trong can đã mở nắp: 75 ngày. Bảo quản: 15 - 30 độ C	4	Can

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Đơn vị cung ứng phải đáp ứng các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản trang thiết bị y tế và giao hàng tại khoa Dược-VTTYT, Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn.


2. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong tháng 01 năm 2025.

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sau khi hoàn thành công việc thì thanh toán.

4. Các thông tin khác: (Nếu có )

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, KD-VTTYT.

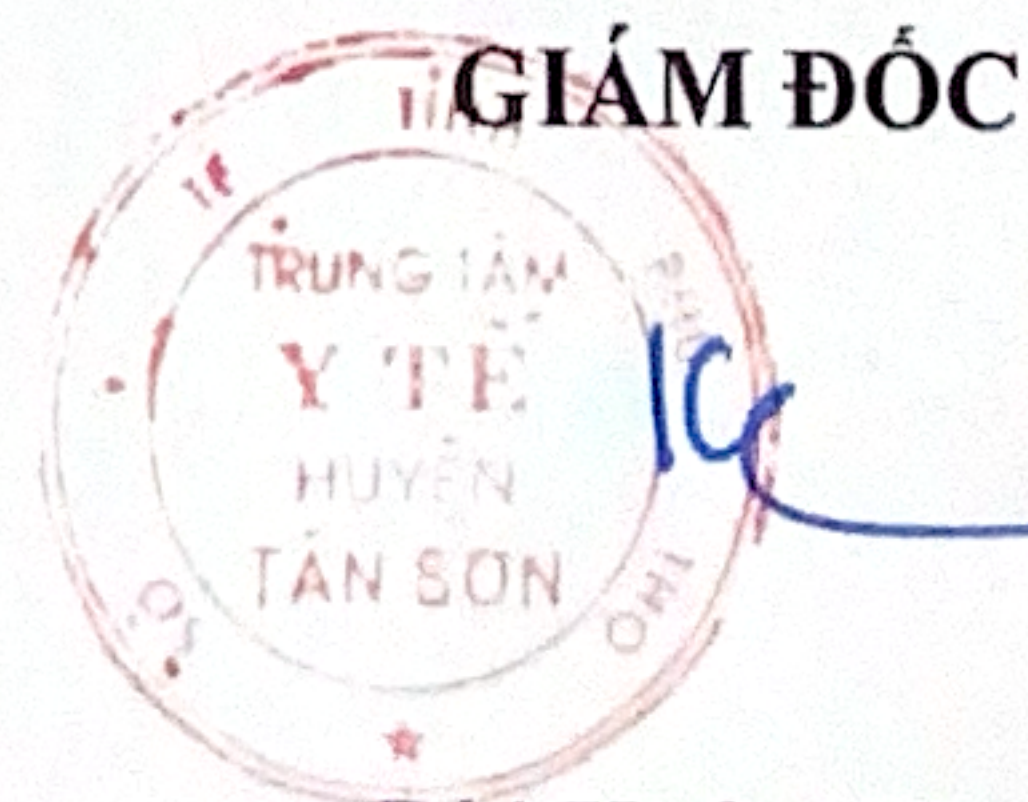

**Bùi Xuân Khánh**