

Số: 247/CV-TTYT
V/v mời cung cấp báo giá

Tân Sơn, ngày 15 tháng 05 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ chuyên môn của Trung tâm y tế huyện Tân Sơn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn
- Địa chỉ: Khu 5b - xã Tân Phú - huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà: Bùi Thị Vân Anh
- Chức vụ: Thủ kho vật tư y tế
- Số điện thoại: 0976.301.425
- Email: khoaduocbvtanson@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược - VTYT, địa chỉ: Trung tâm y tế huyện Tân Sơn, khu 5b - xã Tân Phú - huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ.
- Nhận qua email: khoaduocbvtanson@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 17h ngày 25.. tháng 05. năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25. tháng 05. năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư, sinh phẩm y tế:

(theo phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Đơn vị cung ứng phải đáp ứng các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản thiết bị y tế và giao hàng tại khoa Dược - VTYT Trung tâm y tế huyện Tân Sơn.


3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sau khi hoàn thành công việc thì thanh toán.


5. Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐKH, TCKT, KD.

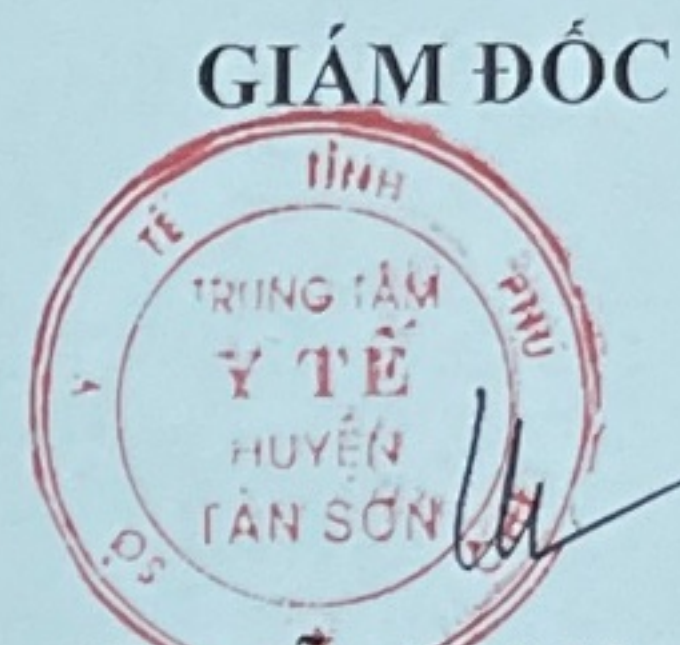

Nguyễn Thị Hạnh

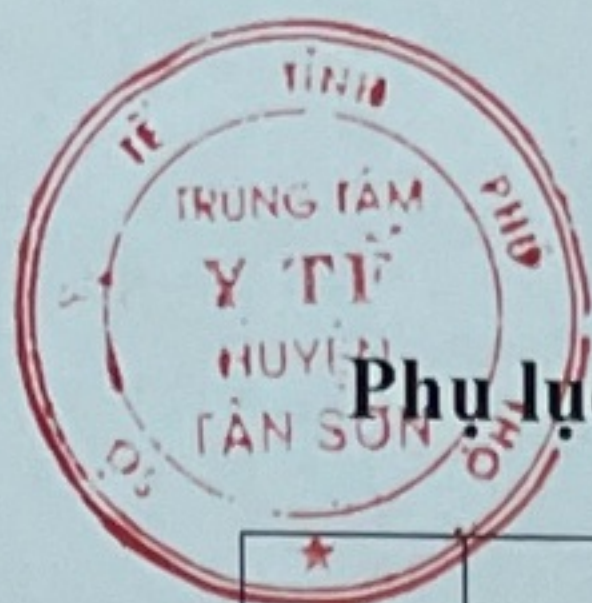

Phụ lục 1: Danh mục Hóa chất, Sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao cần báo giá

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	ĐVT
1	STA Cuvett Satellite 6x220	Cuvette bằng nhựa dùng một lần, có bi làm bằng thép không gỉ bên trong	8	Thùng
2	STA - Cleaner Solution	Dung dịch rửa pha sẵn cho các hệ thống phân tích đông máu tự động.	3	Can